

Автоматический мини-инкубатор 24А

Руководство пользователя


Для обеспечения наилучшей выводимости перед началом эксплуатации просим внимательно ознакомиться с данным Руководством.




1. Комплект поставки включает в себя: инкубатор на 24 яйца, руководство пользователя, защитный пенопласт, спринцовку и шнур электропитания.




2. Разъем питания.

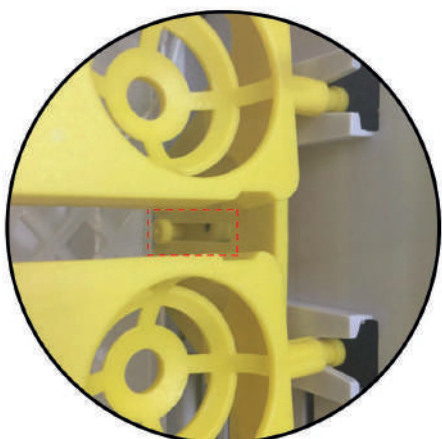


3. Убедитесь, что лоток для яиц правильно соединен с разъемом вала электродвигателя.

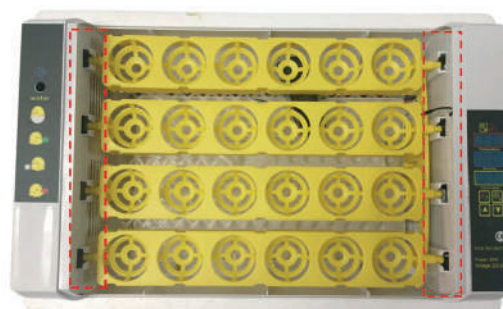


4. Убедитесь, что лоток для яиц вставлен в направляющие с двух сторон.

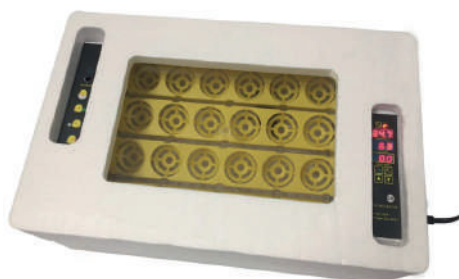

5. Убедитесь, что вентилятор, дисплей температуры, функциональные клавиши и нагреватель работают. Установите инкубатор в пенопластовый кожух, если температура в помещении менее 20°C.

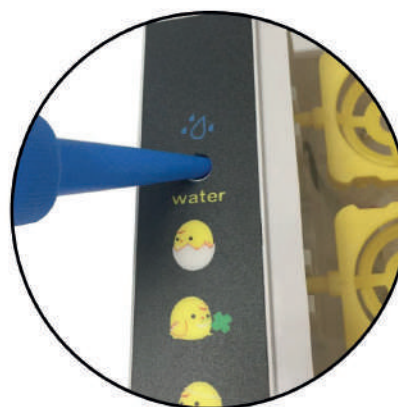

6. Добавьте теплую воду в инкубатор, прогрейте инкубатор 20-30 минут, пока температура не стабилизируется и можете закладывать яйца.

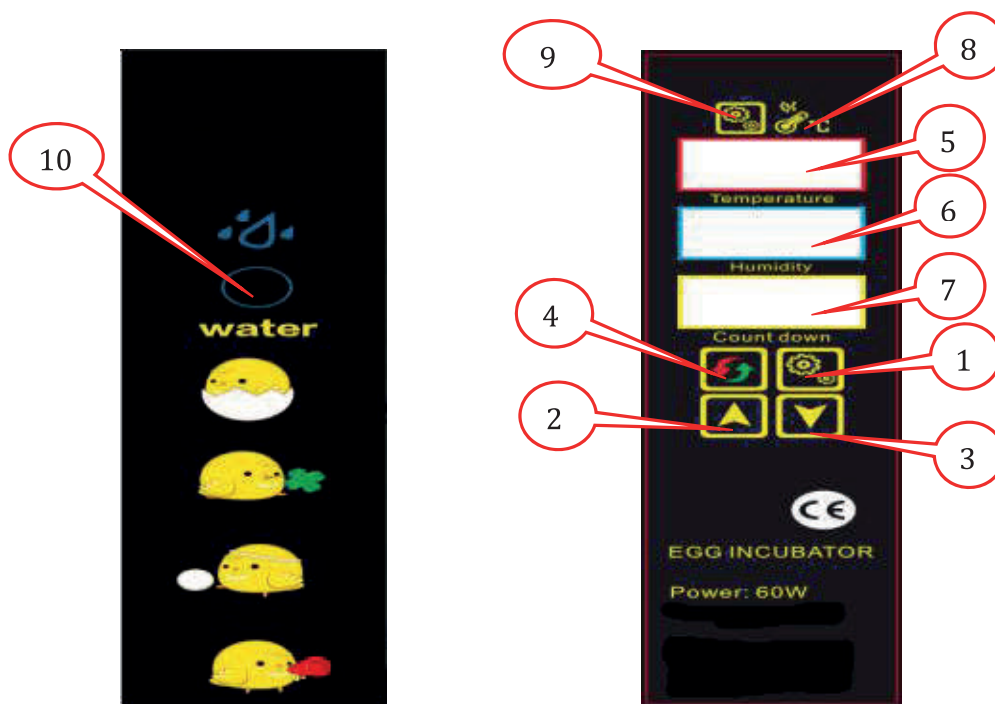

- 1 — Кнопка настройки
- 2 — Кнопка увеличения/выбора функции
- 3 — Кнопка уменьшения/выбора функции
- 4 — Кнопка перезагрузки
- 5 — Температура
- 6 — Влажность
- 7 — Обратный отсчет/дни выведения
- 8 — Лампочка индикатора нагрева
- 9 — Лампочка индикатора настройки
- 10 — Отверстие для воды

I. Настройка контроллера

1. Проверка инкубатора перед первой эксплуатацией:

- 1.1 Подключите механизм поворота яиц к блоку контроля.
- 1.2 Подключите шнур питания к источнику питания.
- 1.3 Включите источник питания.
- 1.4 Включите инкубатор.
- 1.5 Вы услышите звуковое предупреждение из-за низкой температуры/ влажности, не волнуйтесь, это нормально.
- 1.6 Нажатие любой кнопки отключит звуковое предупреждение.
- 1.7 Заполните гидроканалы водой, чтобы постепенно увеличить уровень влажности.
- 1.8 Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы проверить функцию автоматического переворачивания яиц. Яйца переворачиваются каждые два часа в течение 10 секунд.

2. Установка температуры:

- 2.1 Нажмите "SET".
- 2.2 Выберите температуру кнопками "+" и "-".
- 2.3 Повторно нажмите "SET", чтобы выйти из режима настройки. По умолчанию, температура составляет 38 °C.

3. Задание пороговых значений для срабатывания сигнала при отклонении от заданной температуры (AL & AH):

По умолчанию, пороговые значения для срабатывания сигнала при отклонении от заданной температуры установлены на 1°C. Этих настроек достаточно, менять ничего не нужно.

3.1 Сигнал о пониженной температуре(AL):

3.1.1 Зажмите "SET" на 3 секунды.

3.1.2 Нажимайте "+" или "-", пока на экране вывода температуры не появится аббревиатура "AL".

3.1.3 Нажмите "SET".

3.1.4 Нажмите «+» или «-» для изменения допустимого уровня понижения температуры.

3.2 Сигнал о повышенной температуре(AH):

3.2.1 Зажмите "SET" на 3 секунды.

3.2.2 Нажимайте "+" или "-", пока на экране вывода температуры не появится аббревиатура "AH".

3.2.3 Нажмите "SET".

3.2.4 Нажмите «+» или «-» для изменения допустимого уровня повышения температуры.

4. Настройка сигнала при отклонении от заданной влажности (AS):

По умолчанию, сигнал при отклонении от заданной влажности установлен на влажность 45%. Этих настроек достаточно, менять ничего не нужно.

4.1 Установка сигнала при возникновении пониженного уровня влажности (AS).

4.2 Зажмите "SET" на 3 секунды.

4.3 Нажимайте "+" или "-", пока на экране вывода температуры не появится аббревиатура "AS".

4.4 Нажмите "SET".

4.5 Нажмите "+" или "-" для изменения критического уровня влажности, при котором сработает сигнал-предупреждение.

5. Установка поправки в показания температурного датчика (CS):

Изначально температурный датчик установлен на значение 0°C. Если имеются расхождения между показаниями датчика и эталонного термометра, нужно определить разницу в показаниях и установить ее в качестве поправки.

5.1 Установка поправки в показания температурного датчика. (CS)

5.2 Зажмите "SET" на 3 секунды.

5.3 Нажимайте "+" или "-", пока на экране вывода температуры не появится аббревиатура CS.

5.4 Нажмите "SET".

5.5 Нажмите "+" или "-" для установки поправки.

Обратите внимание, что регулировка - это разница между показаниями термометра.

При настройке нажмите "-", если термометр инкубатора показывает слишком высокую температуру, и "+", если термометр инкубатора показывает слишком низкую температуру.

6. Настройка верхнего и нижнего температурных пределов (HS и LS):

HS -(верхний предел) и LS -(нижний предел) - это пределы рабочей температуры инкубатора, в рамках которых будет настраиваться температура.

Если HS - 38,2, а LS - 37,4, температура (регулировка температуры инкубации) может быть изменена только с 38,2 до 37,4, т.е. минимальная температура будет всегда 37,2, даже если продолжить нажимать "-". То же касается и верхнего предела.

7. Значения символов

| Пункте | Symbol | Значение | Заводские настройки |
|--------|--------|---|---------------------|
| 1.1 | AL | Сигнал о повышенной темп. | 1°C |
| 2.1 | АН | Сигнал о пониженной темп. | 1°C |
| 3.1 | AS | Сигнал отклонения от заданной влажности | 45% |
| 4.1 | CS | Поправка темп. датчика | 0°C |
| 5.1 | HS | Верхний темп. предел | 39.5°C |
| 6.1 | LS | Нижний темп. предел | 30°C |

II. Проверка инкубатора перед первой эксплуатацией

1. Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность инкубатора.
2. Подсоедините механизм переворота яиц к разъему управления в инкубационной камере.
3. Залейте воду в один или два гидроканала, исходя из влажности окружающей среды.
4. Разместите яйца в инкубаторе острым концом вниз.
5. Закройте крышку и включите инкубатор.
6. Нажмите кнопку перезагрузки (зеленая кнопка слева) и запустите отсчет дней с "0" (пойдет обратный отсчет до переворачивания яиц 1:59).
7. При необходимости доливайте воду в гидроканал (обычно каждые 4 дня).
8. Через 18 дней выньте лоток для яиц вместе с поворотным механизмом. Переложите яйца на нижнюю решетку, там цыплята вылупятся окончательно.
9. Заполните гидроканал водой для увеличения влажности во время вылупления цыплят (скорлупа должна быть влажная, чтобы цыпленок мог ее проклюнуть).
10. Сброс до заводских установок:
 - выключаем из сети
 - одновременно нажать кнопки «вверх» и «вниз» (стрелка вверх, стрелка вниз)
 - с зажатыми кнопками включаем в сеть.

Инкубатор ННД YZ-24А

| | |
|----------------------------|----------------|
| Модель: | YZ-24A |
| Вместимость яиц (куриные): | 24 |
| Точность термостата: | 0.1°C |
| Переворот: | автоматический |
| Питание: | 220V |
| Мощность МАХ: | 80 Вт |
| Габариты: | |
| Длина, см | 44 |
| Ширина, см | 29 |
| Высота, см | 17 |
| Вес, кг | 2,15 |
| Материал корпуса: | ABS-пластик |
| Дисплей: | цифровой |
| Бренд: | ННД |
| Страна изготовитель: | Китай |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: Nanchang Edward Co., LTD
Стр. 5, №8 Гаоксин Роад, Наньчан сити, провинция Цзянси, Китай
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.
тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.